scan▸X®

Instruções para Folhas de Limpeza ScanX

AIR TECHNIQUES equipped for life™

Introdução.

A seguir, são fornecidas instruções para uso das Folhas de Limpeza ScanX, visando garantir um funcionamento ótimo do ScanX.

A reutilização da Folha de Limpeza pode causar a reposição de detritos previamente removidos no mecanismo de transporte do ScanX.

Uso dental recomendado

Quando o ScanX for utilizado na prática odontológica, limpe-o uma vez por mês.

Uso veterinário recomendado

Quando o Scan X for utilizado em aplicações veterinárias, limpe-o uma vez por dia. Utilize uma nova Folha de Limpeza Scan X de cada vez para obter melhores resultados.

Procedimento.

1. Ligue e ative o ScanX utilizando o modo de resolução 5 LP/mm (padrão extra oral).
2. Retire uma Folha de Limpeza da caixa..
3. Conforme ilustrado na Figura 1, remova o papel antiaderente da Folha de Limpeza, expondo a sua superfície adesiva.
4. Manuseie a Folha de Limpeza ScanX pelas bordas curtas com o lado adesivo em direção à região de limpeza do Sca
5. Continue segurando a folha entre as pontas dos dedos de ambas as mãos e curve a dimensão longitudinal da Folha de Limpeza ScanX, de modo que a face adesiva esteja no lado interno (côncavo).

Evite pressionar o lado adesivo da Folha de Limpeza contra o slot de entrada para evitar o arraste excessivo na folha.

6. Alinhe a ondulação da Folha de Limpeza com a entrada do ScanX (veja Figura 2), e enquanto inclina levemente a mesma mantendo distância da superfície de entrada, insira a borda principal da Folha de Limpeza no slot de entrada do ScanX.
7. De forma lenta e cuidadosa, incline a Folha de Limpeza em direção ao ScanX enquanto a empurra gentilmente para o slot de entrada, até que o mecanismo de transporte se encontre com a folha e a transporte para o interior do ScanX.
8. Permita que a Folha de Limpeza deslize através do ScanX até que saia completamente do transporte.
9. Caso a Folha de Limpeza pareça limpa o suficiente para ser reutilizada, guarde-a com o lado adesivo virado para o lado brilhante do papel antiaderente reutilizável , conforme ilustrado na Figura 3.

Folhas de Limpeza ScanX
Caixa com 12 unidades, código B2010
Caixa com 25 unidades, código B2020
Um papel antiaderente reutilizável é incluso em cada caixa.

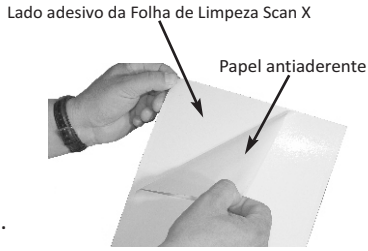

Figura 1. Remoção do papel antiaderente da Folha de Limpeza Scan X.

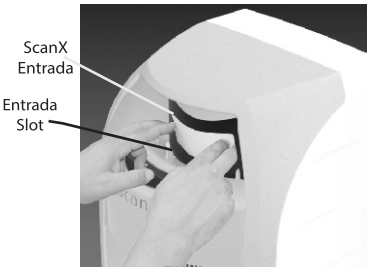

Figura 2. Alinhamento da Folha de Limpeza ScanX com a porção adesivada direcionada para a entrada

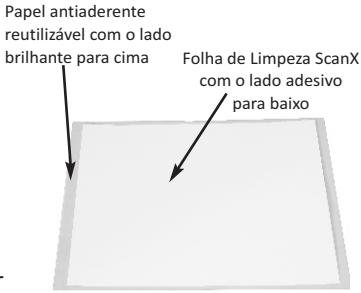

Figura 3. Armazenamento da Folha de Limpeza ScanX no papel antiaderente reutilizável.

P/N D1013-PT Rev. D

Air Techniques, Inc.
1295 Walt Whitman Road
Melville, Nova York 11747 USA

CE

EC REP Serviço de segurança de dispositivos médicos
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Alemanha